Précautions et mises en garde

• Sans latex. Si vous faites une réaction à une pièce quelconque de ce masque ou de ce harnais, cessez immédiatement de l'utiliser.
• Aux États-Unis, la loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin.
• Ce dispositif doit être utilisé uniquement avec les appareils CPAP ou à deux niveaux de pression recommandés par votre médecin ou un inhalothérapeute.
• Ce masque ne doit être utilisé que lorsque l'appareil CPAP ou à deux niveaux de pression est allumé et fonctionne bien.
• Les orifices de ventilation ne doivent jamais être bouchés.
• Abstenez-vous de fumer lors de l'utilisation de ce produit.
• Si votre masque est partagé entre patients, vous devez le nettoyer et le désinfecter en ne suivant que des méthodes de nettoyage et de désinfection approuvées. Aucune méthode de stérilisation n'a été validée pour ce produit. N'utilisez pas de javel ou de solvant contenant du trichloroéthylène.
• Votre masque doit être nettoyé selon le besoin pour empêcher toute contamination par des impuretés et du sébum de votre peau de s'y accumuler.
• Le patient doit nettoyer son visage avant de porter le masque.
• Assurez-vous de bien placer le masque. Les informations imprimées et la languette de réglage doivent être au bas du masque.
• Le patient ne doit pas modifier la conception du masque.
• Ne faites pas sécher le masque dans une sécheuse.

Garantie limitée

• www.circadiance.com/help

EC REP

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, La Haye
Pays-Bas
Tél. : +31 (0)70 345 8570

CE 0459

Circadiance
1060 Corporate Lane
Export, PA 15632, États-Unis
Tél. : 888-825-9640 ou +1 724-858-2837
cservice@circadiance.com
www.Circadiance.com

Assemblé en République dominicaine avec des pièces fabriquées aux États-Unis.

100675 REV 1

Présentation du masque

La trousse de démarrage du SleepWeaver® élan™ comporte un masque de taille normale fixé au harnais. Un grand tube Feather Weight™ à coussin et une courroie d'attache sont également inclus.

Usage prévu

Le masque CPAP nasal SleepWeaver élan™ Nasal CPAP Mask a pour but de fournir une interface de ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP) ou une thérapie à deux niveaux de pression. Il est destiné à une utilisation répétitive par un seul patient à la maison et à une utilisation répétitive par plusieurs patients dans les hôpitaux et les cliniques. Ce masque doit être utilisé par des patients qui pèsent plus de 30 kg (66 lb).

Orientation du masque

1. Retirez le masque nasal CPAP SleepWeaver élan, le harnais et le tube ultraléger de l'emballage.
2. Veillez à la bonne orientation du masque :

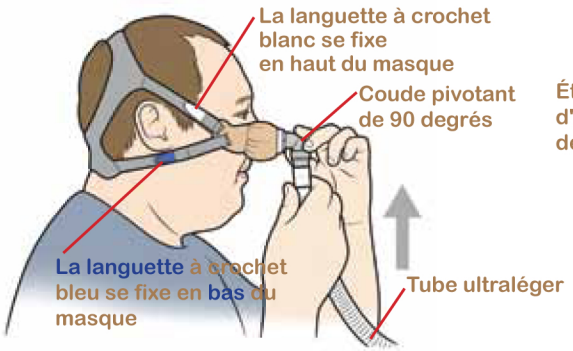

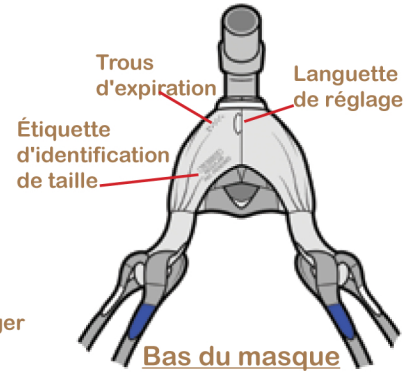

3. Il y a deux tailles offertes (ordinaire et grand) et on peut déterminer la taille en consultant la tampographie au bas du masque.
   a. Si le coussin de taille régulière est trop petit, remplacez-le par le grand coussin.

Réglage du masque directement de la trousse de démarrage

1. Mettez le masque en tirant le harnais sur votre tête.
2. L'appui-nuque du harnais doit reposer confortablement sur la partie inférieure de votre nuque.

IMPORTANT – NE SERREZ PAS TROP LES SANGLES. COMMENCEZ AVEC LES SANGLES RELÂCHÉES PUIS SERREZ-LES AU BESOIN POUR OBTENIR UNE BONNE ÉTANCHÉITÉ.

3. Réglez d'abord les sangles du haut (la languette à crochet blanc) de sorte que le bas du masque repose confortablement sur la lèvre supérieure juste en dessous de vos narines.
4. Réglez les sangles du bas (la languette à crochet bleu) pour tirer le masque confortablement contre votre nez. Un petit bout de tissu noir apparaît quand le masque est en cours d'utilisation.
5. Fixez le tube ultraléger au raccord pivotant de 90 degrés, puis dans le tube de 6 pieds qui se fixe à votre appareil CPAP ou à double niveau. Ensuite, mettez l'appareil en marche.

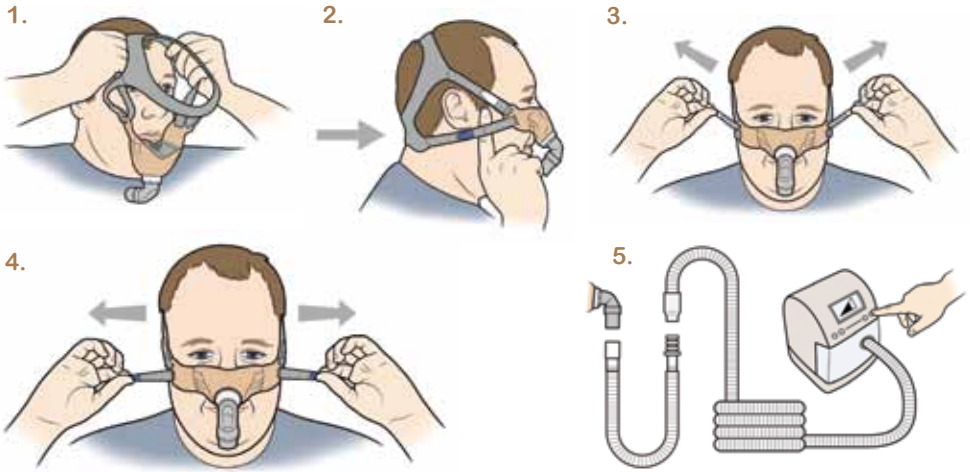

Réglage antifuite - en cas de fuite, suivez ces étapes :

1. Serrez légèrement les sangles de façon progressive pour arriver à une certaine étanchéité.
2. Agitez le masque pour le mettre en place en le faisant déplacer de gauche à droite et de haut en bas. La languette de réglage en bas du masque peut vous faciliter cette tâche.

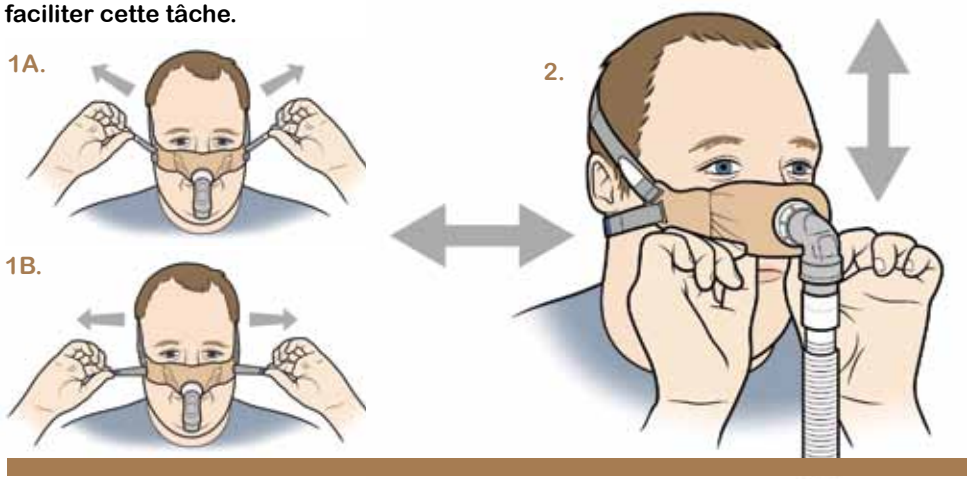

Fixer le masque au harnais

1. Faites glisser les languettes à crochet « blanc » à travers les fentes supérieures du coussin.
2. Faites glisser les languettes à crochet « bleu » à travers les fentes inférieures du coussin.

Fixez le coude pivotant de 90 degrés au coussin du masque

1. Faites glisser la molette filetée dans l'ouverture de l'intérieur du masque.
2. Mettez la rondelle sur la molette filetée.
3. Assurez-vous que le tissu n'accoste pas sur la molette filetée.
4. Vissez l'écrou sur molette filetée.

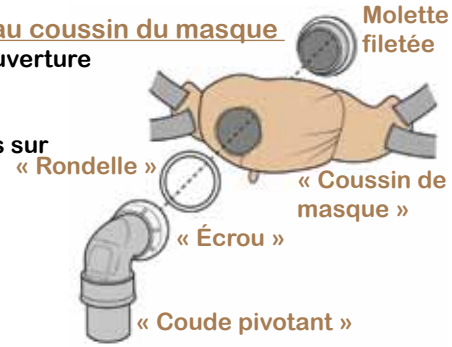

Fixer la courroie d'attache au harnais

1. Fixez la courroie d'attache au tube ultraléger et en haut du harnais pour faciliter la manipulation du tube si vous placez ce dernier au-dessus de votre tête.
2. Assurez-vous que la courroie d'attache ne soit pas tordue lorsqu'elle est fixée.

Nettoyer le masque à la maison

- Votre SleepWeaver élan™ doit être nettoyé à la main avec un savon doux non abrasif et de l'eau tiède après chaque utilisation. N'utilisez jamais d'eau chaude. Recommencez le lavage jusqu'à ce que le masque soit visiblement propre.
- Rincez-le bien avec de l'eau potable, puis laissez-le sécher à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Vous pouvez garder le coude pivotant de 90 degrés fixé pendant le nettoyage ou le retirer et le nettoyer séparément.
- Lavez le harnais à la main, chaque semaine.

Nettoyage et désinfection entre patients

- Pour obtenir des instructions, consultez le site Web suivant : www.circadiance.com/help.

Soupape d'expiration

Il n'y a pas de jet d'air lors de l'expiration. La ventilation se fait par une série de trous minuscules. Le débit de la soupape d'expiration ainsi que les fuites du pivot et d'autres sources:

Pression (cm H_20)	4	5	10	15	20
Débit (l/min.) - régulier	15.4	18.6	32.4	44.8	57.2
Débit (l/min.) - grand	16.1	19.2	33.8	46.2	59.6

Le SleepWeaver élan™ a été mis à l'essai à des pressions de 4 cm H_20 à 20 cm H_20 sur des appareils CPAP et à deux niveaux de pression.